


Procédure simplifiée d'installation


Etape 6



1000 ml

500 ml


Etape 1




Etape 2

Mettre l'interrupteur de la chambre sur « + ». En cas de non pressurisation de la chambre, vérifier la position de l'interrupteur du compresseur.

Etape 3




Etape 4




Etape 5


Purger l'ensemble de la tubulure en retournant le débulleur

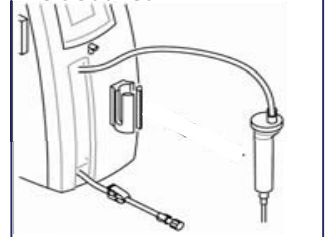


Etape 7

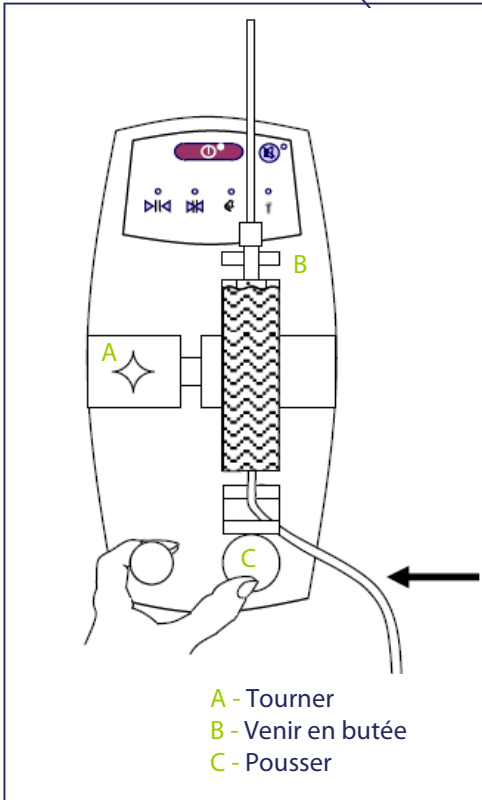


Bouton marche / Arrêt du compresseur

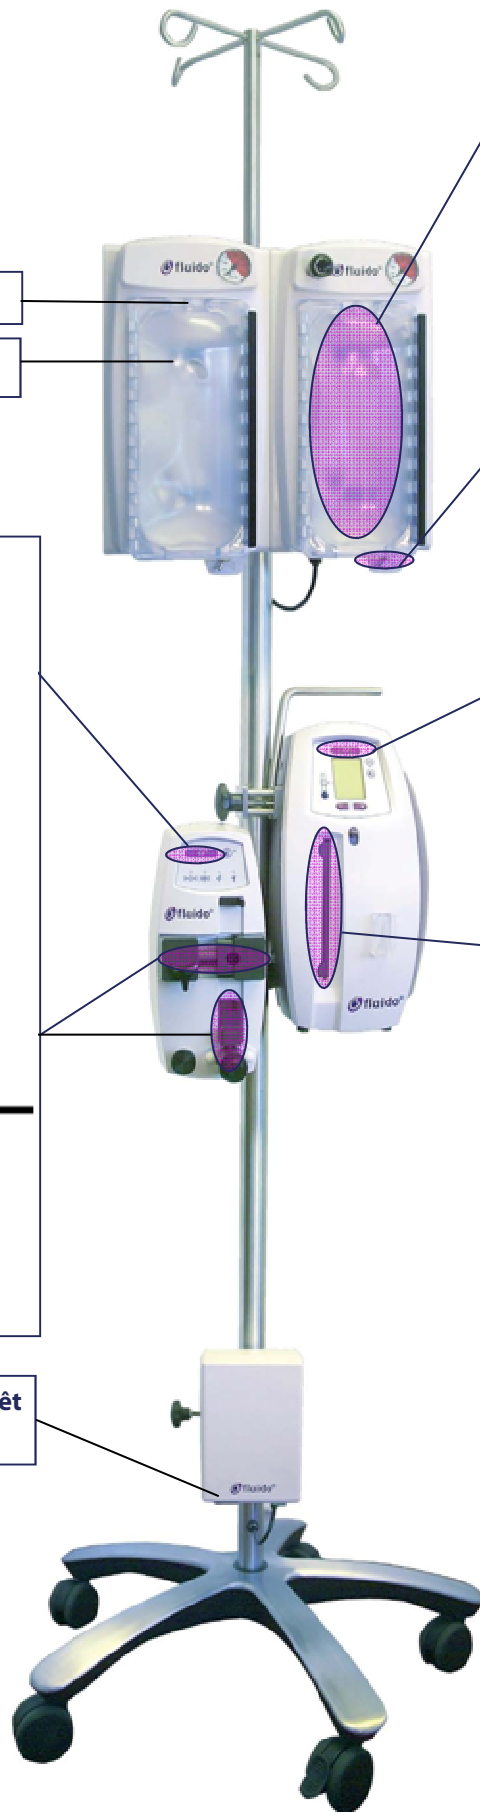

Réglage du réchauffeur

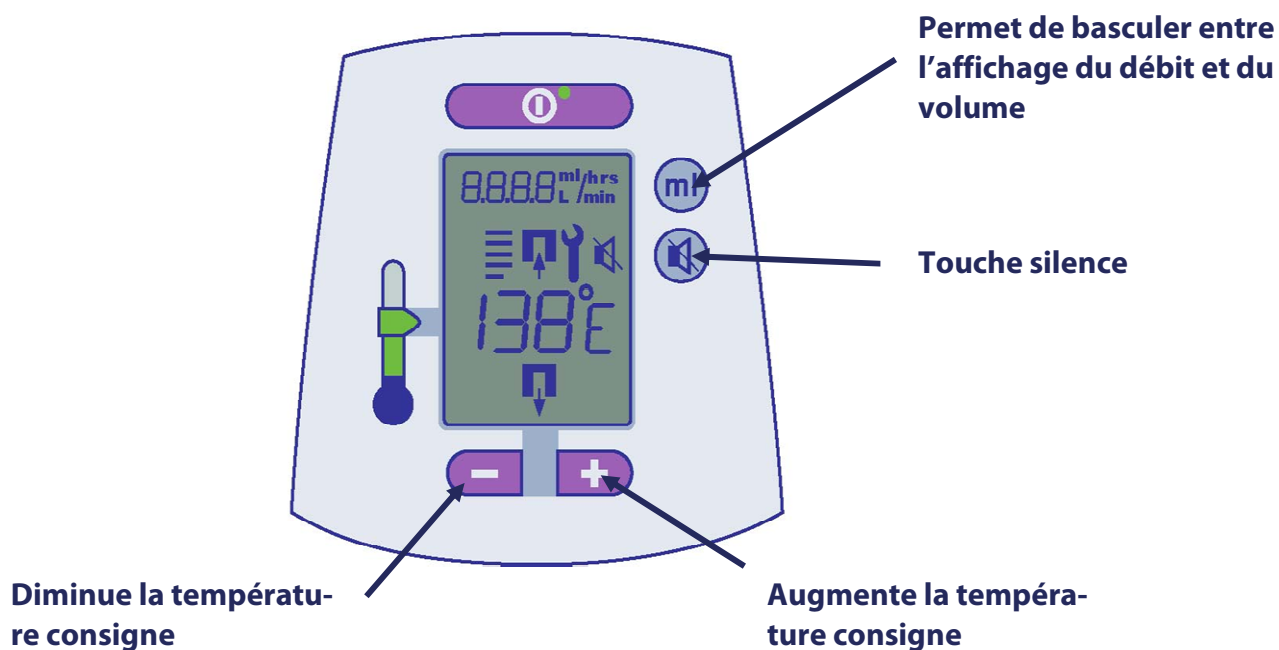

Procédure de réinitialisation du réchauffeur

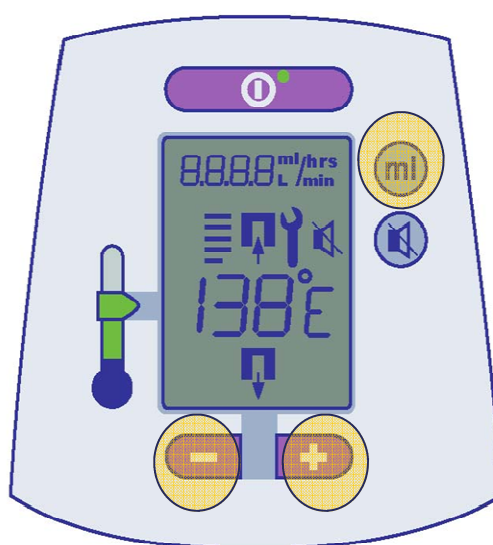

Appuyez simultanément sur les 3 touches « - » « + » et « ml ».